



## بررسی ترکیبات آلی فرار در هوای خروجی دستگاه‌های بی‌خطر ساز پسماندهای بیمارستانی با حرارت پایین در چهار بیمارستان شهر تهران در سال ۱۳۹۰

مهدی فرزادکیا<sup>۱</sup>، حمید غلامی<sup>۲</sup>، علی اسرافیلی<sup>۳</sup>، علی اصغر فرشاد<sup>۴</sup>، مجید کرمانی<sup>۵</sup>

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۲/۲۳

تاریخ ویرایش: ۹۲/۰۵/۳۱

تاریخ پذیرش: ۹۲/۰۸/۰۴

### چکیده

**زمینه و هدف:** کاربرد دستگاه‌های بی‌خطر سازی پسماند با حرارت پایین در بیمارستان‌های کشور رو به افزایش است. احتمال تولید ترکیبات آلی فرار (VOCs) و خطرناک در هوای خروجی از این دستگاه‌ها وجود دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ترکیبات آلی فرار در هوای خروجی این دستگاه‌ها در چهار بیمارستان شهر تهران می‌باشد.

**روش بررسی:** این تحقیق در بیمارستان‌های مجهز به دستگاه‌های بی‌خطر سازی از نوع: هیدروکلاو، اتوکلاو دارای خردکن، اتوکلاو بدون خردکن و دستگاه حرارت خشک انجام گرفت. از هر دستگاه ۱۰ نمونه به صورت هفتگی در فاصله ۱ فروردین تا تیر سال ۱۳۹۰ تهیه شد. نمونه برداری با روش NIOSH ۱۵۰۱ انجام گرفت. نمونه‌ها در دو فاز کیفی و کمی با دستگاه GC-mass مورد سنجش قرار گرفته و نتایج با حدود مجاز مواجهه شغلی کوتاه مدت (OEL- STEL) ارائه شده توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت مقایسه شدند.

**یافته‌ها:** در فاز اول وجود ترکیبات BTEX (بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلین) بطور میانگین در ۹۰ درصد از نمونه‌ها تایید شد. فاز دوم نشان داد که بالاترین غلظت‌های BTEX با میانگین ۹/۳۵ ppm به دستگاه اتوکلاو دارای خردکن و کمترین غلظت BTEX با میانگین ۱/۲۵ ppm به دستگاه اتوکلاو بدون خردکن تعلق دارد. به لحاظ پاکیزگی هوای خروجی، اتوکلاو بدون خردکن، هیدروکلاو، حرارت خشک و اتوکلاو با خردکن به ترتیب رتبه‌های ۱ تا ۴ را به خود اختصاص دادند.

**نتیجه‌گیری:** غلظت گازهای بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلین در تمام نمونه‌ها از حدود مجاز مواجهه شغلی کوتاه مدت پایین تر بود. حضور ترکیبات آلی فرار در اکثر نمونه‌های اخذ شده با توجه به عمر کوتاه راه اندازی این دستگاه‌ها (بین ۳ تا ۹ ماه)، ضمن تایید پتانسیل مخاطره آمیز بودن این دستگاه‌ها برای کارگران، پایش مستمر هوای خروجی آنها را مورد تاکید قرار می‌دهد.

**کلیدواژه‌ها:** دستگاه‌های بی‌خطر ساز پسماند، پسماند بیمارستانی، ترکیبات آلی فرار، BTEX، هوا

### مقدمه

مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی در کشورهای در حال توسعه در ارتباط می‌باشند [۳]. در همین ارتباط سازمان جهانی بهداشت (WHO)، طی گزارشی در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد که سالانه ۲۱ میلیون مورد هپاتیت B، ۲ میلیون مورد هپاتیت C و ۲۶۰ هزار مورد ایدز در اثر تماس با سرنگ‌های آلوده در سراسر جهان ایجاد می‌شود [۴]. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه ۵/۲ میلیون نفر (شامل ۴ میلیون کودک) در اثر تماس

پسماندهای بیمارستانی در حدود ۱ تا ۲ درصد از مواد زاید جامد شهری را در ایران تشکیل می‌دهند [۱]. این پسماندها علی‌رغم اینکه حجم پایینی از ترکیب زباله‌های شهری را تشکیل می‌دهند، به دلیل حساسیت‌ها و پتانسیل خطرزایی بالا، نیازمند توجه و مدیریت ویژه می‌باشند [۲]. مطالعات نشان می‌دهد که بسیاری از بیماری‌های عفونی با وضعیت نامناسب

۱- (نویسنده مسئول) دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. mahdifarzadkia@gmail.com

۲- دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

۳- استادیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

۴- مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

۵- استادیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

تصفیه پسماندهای بیمارستانی پیدا کرده اند [۱۲]. در اتوکلاو و هیدروکلاو عملیات بی‌خطر سازی توسط حرارت مرطوب (۱۲۱ تا ۱۳۸ درجه سانتیگراد) به همراه فشار بخار ۴ بار و در دستگاه حرارت خشک این عملیات توسط حرارت خشک (۱۳۰ تا ۱۵۵ درجه سانتیگراد) همراه با کاربرد گندزدای شیمیایی انجام می‌گیرد [۱۳ و ۱۴]. پسماندهای عفونی پس از بی‌خطر سازی در این دستگاهها همانند زباله های شهری دفع می‌شوند. این دستگاهها عموماً برای بی‌خطر سازی پسماندهایی نظیر کیسه های خون و ادرار، اشیاء نوک تیز و برنده، مواد عفونت زای ناشی از آزمایشگاههای تحقیقاتی و تشخیصی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به کارگیری آنها برای پسماندهای رادیو اکتیو و پاتولوژیک توصیه نمی‌شود [۱۵]. آنچه که مسلم است ورودی این دستگاهها، پسماندهای جامد و عفونی بیمارستانی بر اساس ظرفیت دستگاه بوده اما خروجیهای آنها در سه شکل پسماندهای جامد، فاضلاب، گازها و بخارات می‌باشد. با توجه به ترکیب پسماندهای بیمارستانی هر یک از این خروجیها قبل از تخلیه و دفع بایستی معیارهای بهداشتی و زیست محیطی لازم را کسب نمایند [۸]. در دستورالعمل پایش سیستم های بی‌خطر ساز مصوب ۱۳۹۰ وزارت بهداشت، پایش فیزیکی عملکرد این دستگاهها و کنترل کیفیت میکروبی پسماندهای خروجی از آنها در نظر گرفته شده، ولی متأسفانه توجه لازم به کیفیت هوا و فاضلاب خروجی این دستگاهها نشده است [۸]. با توجه به درصد بالای مواد پلاستیکی در پسماندهای عفونی [۶]، فشار و دمای بالا در این دستگاهها می‌تواند تولید گازهای آلی فرار و سمی زیادی را در پی داشته باشد. بدیهی است که عدم کنترلهای لازم در این خصوص، موجب راهیابی گازهای سمی به هوای خروجی این دستگاهها شده و خطرات زیادی را متوجه سلامت کارکنان، بیماران و عموم مردم می‌نماید [۱۶].

بررسیها نشان می‌دهد که دی‌اکسین ها و فورانها درطیف دمایی بین ۲۸۰ تا ۴۵۰ درجه ی سانتیگراد

با پسماندهای عفونی جان خود را از دست می‌دهند [۵]. در سال‌های اخیر گزینه‌های زیادی جهت بی‌خطر سازی پسماندهای بیمارستانی به روش‌های شیمیایی و فیزیکی بکار گرفته شده که هر کدام از مزایا و محدودیت‌هایی برخوردارند [۶]. یکی از پرکاربردترین تکنولوژیها در این خصوص استفاده از کوره‌های زباله سوز است. این روش در بسیاری از کشورها گزینه اصلی بی‌خطر سازی پسماندهای بیمارستانی محسوب می‌گردد. بررسیها نشان می‌دهد که با وجود قدمت زیاد و کاربرد گسترده این کوره ها، متأسفانه در کشور ما نتایج موثر و تجارب موفقی از آنها به دست نیامده است [۷]. عدم حصول نتایج مطلوب از کاربرد کوره های زباله سوز در کشور موجب گردید تا مسئولین ذیربط ضمن عبور از این تکنولوژی، گزینه های دیگر را مورد توجه قرار دهند. ماده‌ی ۶۵ ضوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماندهای پزشکی (دستورالعمل مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت، سال ۱۳۸۸) استفاده از روش های حرارتی غیر سوز را، برای بی‌خطر سازی پسماندهای عفونی مورد تاکید قرار می‌دهد [۸]. سیستم های حرارتی غیرسوز در کشورهای پیشرفته به عنوان روشی متداول برای امحای پسماندهای عفونی پذیرفته شده است. به عنوان مثال ۷۸٪ پسماندهای عفونی مراکز درمانی ایالت واشنگتن در آمریکا به وسیله ی این دستگاهها بی‌خطر می‌شوند و فقط ۲۳٪ از پسماندهای عفونی به طور مستقیم به سایت های زباله سوزی منتقل می‌گردند [۹]. در سال ۲۰۰۵، ۳۹٪ پسماندهای عفونی در ژاپن توسط سیستم های حرارتی غیرسوز امحا شدند [۱۰]. در ترکیه دستگاههای حرارتی غیرسوز به صورت سایت های مرکزی در حومه ی شهرها به کاربرده شده و بیش از ۹۴٪ پسماندهای عفونی شهر استانبول در این سایت ها بی‌خطر سازی و گندزدایی می‌گردند [۱۱].

اتوکلاو، هیدروکلاو و دستگاه حرارت خشک، از جمله دستگاههای بی‌خطر ساز با دمای پایین (غیر سوز) هستند که در سالهای اخیر کاربرد زیادی برای

بود و درفاصله ی فروردین تا تیر ماه سال ۱۳۹۰ نمونه‌ها جمع آوری شدند. برای نمونه برداری روش NIOSH ۱۵۰۱ به کار گرفته شد. این روش برای اندازه گیری ترکیبات آلی فرار موجود در هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد [۲۲]. بر مبنای این روش هوای خروجی از طریق پمپ نمونه بردار فردی از روی بستر جاذب عبور داده می‌شود و آلاینده‌ها توسط فضا‌های موجود در جاذب به دام انداخته می‌شوند. نمونه برداری از هوای خروجی دستگاهها پس از پایان سیکل کاری آنها و بازشدن درب آنها انجام شد. نمونه برداری حدود ۱۵ دقیقه بود و در هر بار ۵ لیتر هوا توسط پمپ نمونه بردار از دستگاههای بی‌خطر ساز جمع آوری شد.

نمونه‌ها پس از جمع آوری فوراً به آزمایشگاه منتقل شده و تا زمان آزمایش در دمای کمتر از ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری گردید. ترکیبات مورد نظر به وسیله ۱ میلی‌لیتر دی‌سولفید کربن از روی جاذب به کمک حمام اولتراسونیک استخراج شدند. نمونه‌ها پس از آماده‌سازی به دستگاه گاز کروماتوگرافی تزریق شدند و اندازه‌گیری کمی و کیفی روی این ترکیبات انجام گردید.

در مرحله‌ی اول بر مبنای روش (EPA(TO-14), ۴۰ ترکیب هدف به صورت کیفی به لحاظ حضور و یا عدم حضور مورد بررسی قرار گرفتند [۲۳]. در مرحله‌ی دوم ترکیبات عمده‌ای که در بخش اول پژوهش مشاهده شده بود، به صورت عددی تعیین مقدار گردیدند. برای این منظور منحنی کالیبراسیون استاندارد برای هر یک از ترکیبات مشاهده شده رسم شد. سپس با مقایسه‌ی پیک‌های منحنی کالیبراسیون و پیک‌های به دست آمده از نمونه‌ها، مقادیر عددی تعیین گردید. نتایج نهایی به دست آمده از نمونه‌ها با حدود مجاز مواجهه شغلی کوتاه مدت (OEL- STEL) معتبر جهانی و موارد تعیین شده توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ایران مورد مقایسه قرار گرفت [۲۴-۲۶].

محاسبات نهایی ترکیبات آلاینده در معادله‌ی ۱ نمایش داده شده است. در این معادله Wf نشانگر

تشکیل می‌شوند، این دامنه بسیار بالاتر از دمای کارکرد دستگاههای بی‌خطر ساز غیرسوز می‌باشد [۱۷-۱۹]. با این وجود تجهیزات بی‌خطر ساز غیرسوز ممکن است مقادیری از الکل، آلدئید، هیدروکربورهای آروماتیک و سایر ترکیبات آلی را در هوا آزاد نمایند. بر این اساس پایش و کنترل مستمر هوای خروجی این دستگاهها ضروری به نظر می‌رسد [۲۰ و ۲۱]. با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت در حال حاضر تمام بیمارستان‌های شهر تهران اقدام به نصب و راه اندازی سیستم‌های بی‌خطر ساز نموده‌اند. براساس مشاهدات بیش از ۹۰٪ از این تاسیسات از نوع دستگاههای حرارتی غیرسوز می‌باشند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ترکیبات آلی فرار در هوای خروجی دستگاههای بی‌خطر ساز پسماندهای بیمارستانی با حرارت پایین در ۴ بیمارستان شهر تهران است. این دستگاهها شامل هیدوکلاو، اتوکلاو دارای خردکن، اتوکلاو بدون خردکن و دستگاه حرارت خشک می‌باشند.

### روش بررسی

**مواد و تجهیزات مورد استفاده:** در این تحقیق برای نمونه برداری از هوای خروجی دستگاهها از پمپ نمونه بردار فردی SKC استفاده شد. همچنین از جاذب 2000 lot (کربن فعال تهیه شده از پوست آناناس) استفاده گردید. به منظور واجذب ترکیبات آلی فرار از جاذب کربن فعال، از حلال دی‌سولفید کربن تولید شده توسط کمپانی مرک استفاده شد.

برای آنالیز آلاینده‌های موجود در هوای خروجی دستگاهها، روش کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی به کار گرفته شد. ستون استفاده شده ستون کاپیلاری غیر قطبی (DB 5) به طول ۳۰ متر، قطر داخلی ۰/۲۲ میلی‌متر با ضخامت دیواره ۰/۲ میکرون می‌باشد و گاز هلیوم به عنوان گاز حامل استفاده شد.

**روش کار:** از هر یک از دستگاههای بی‌خطر ساز پسماند جامد مستقر در بیمارستان‌های شهر تهران ۱۰ نمونه گرفته شد. توالی نمونه‌گیری به صورت هفتگی

### یافته‌ها

در مرحله ی اول پژوهش (آنالیز کیفی) فقط ترکیبات BTEX (بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن‌ها) در نمونه ها مشاهده شد و سایر ترکیبات آلی فرار در این مرحله تشخیص داده نشد. مقدار عددی هر یک از آلاینده ها برای هر بیمارستان به صورت مجزا ارائه شده است.

**بررسی آلاینده های استریلایزر هیدروکلاو:**  
 غلظت ترکیبات آلی فرار در هوای خروجی دستگاه هیدروکلاو در جدول شماره ی ۱ نمایش داده شده است. همان طور که مشاهده می شود، غلظت BTEX در گستره ی صفر تا ۱۰/۳۸ ppm قرار دارد. بالاترین غلظت های مشاهده شده مربوط به تولوئن به میزان ۵/۸۲۳ ppm می باشد، این آلاینده در ۷۰٪ نمونه ها مشاهده شد. اتیل بنزن و ایزومرهای زایلن نیز در بالاترین غلظت های خود اعداد ۲/۵۴۲ و ۴/۱۵۵ ppm را نشان داده اند. اتیل بنزن و زایلن نیز در ۷۰٪ نمونه ها مشاهده شدند. بنزن در ۴۰٪ نمونه ها مشاهده شد که بیشترین غلظت آن ۰/۵۹۸ ppm بود.

**بررسی آلاینده های استریلایزر اتوکلاو بدون خردکن:** کمترین غلظت آلاینده ها در نمونه های مربوط به این دستگاه مشاهده شد، به طوری که ۳۰٪

غلظت آلاینده در بخش جلویی جاذب و Wb نشانگر غلظت آلاینده در بخش عقبی جاذب می باشد. همچنین نشان دهنده ی غلظت آلاینده در بخش جلویی جاذب شاهد بوده و Bb نشان دهنده ی غلظت آلاینده در بخش عقبی جاذب شاهد می باشد. V حجم هوای نمونه بر حسب لیتر می باشد. R درصد واجذب آلاینده از جاذب است که از بروشور تولید کننده ی جاذب تعیین شده است. C غلظت نهایی آلاینده بر حسب میلی گرم در متر مکعب می باشد [۲۷].

$$(1) C = \frac{(Wf + Wb - Bf - Bb)}{VR}$$

برای تبدیل واحد میلی گرم در مترمکعب به ppm تحت شرایط استاندارد (دما، ۲۵ درجه سانتی گراد و فشار ۷۶۰ میلیمتر جیوه) از معادله ی شماره ی ۲ استفاده شد. در این معادله ۲۴/۴۵ حجم مولی هوا در شرایط استاندارد در نظر گرفته شده و Mw وزن مولکولی ترکیب مورد بررسی می باشد [۲۷].

$$ppm = \frac{mg/m^3}{Mw} \times 24/45$$

جدول ۱- غلظت ترکیبات BTEX در هوای خروجی هیدروکلاو بر حسب ppm

هفته ۱	هفته ۲	هفته ۳	هفته ۴	هفته ۵	هفته ۶	هفته ۷	هفته ۸	هفته ۹	هفته ۱۰
بنزن	۰/۲۶	مشاهده نشد	مشاهده نشد	۰/۰۵۱	مشاهده نشد	۰/۰۴	مشاهده نشد	مشاهده نشد	۰/۵۹۸
اتیل بنزن	۱/۵۸۲	مشاهده نشد	۱/۳۰۴	۲/۵۴۲	مشاهده نشد	۱/۴۶۸	۲/۱۰۷	مشاهده نشد	۱/۰۶۷
تولوئن	۵/۸۲۳	۰/۹۸۸	مشاهده نشد	۵/۷۶۷	۱/۵۹۸	۷/۳۲۹	۴/۷۷۹	مشاهده نشد	مشاهده نشد
زایلن	۱/۴۴۲	۰/۹۸۲	مشاهده نشد	۰/۶۸۱	۱/۸۰۱	۱/۵۴۸	۴/۳	مشاهده نشد	۴/۱۵۵
ΣBTEX	۸/۸۷۳	۱/۹۷	۱/۳۰۴	۹/۰۴۱	۳/۳۹۹	۱۰/۳۸۵	۹/۶۴	مشاهده نشد	۵/۸۲

جدول ۲- غلظت ترکیبات BTEX در هوای خروجی اتوکلاو بدون خردکن بر حسب ppm

هفته ۱	هفته ۲	هفته ۳	هفته ۴	هفته ۵	هفته ۶	هفته ۷	هفته ۸	هفته ۹	هفته ۱۰
بنزن	مشاهده نشد	مشاهده نشد	مشاهده نشد	۰/۰۵۱	مشاهده نشد	۰/۰۶۳	مشاهده نشد	مشاهده نشد	مشاهده نشد
اتیل بنزن	۰/۳۰۲	مشاهده نشد	مشاهده نشد	۰/۳۸۵	مشاهده نشد	۲/۹۹۴	مشاهده نشد	مشاهده نشد	مشاهده نشد
تولوئن	مشاهده نشد	مشاهده نشد	مشاهده نشد	۱/۷۲۲	۰/۶۰۴	مشاهده نشد	مشاهده نشد	۱/۰۹۷	۲/۴۹۷
زایلن	۰/۱۸۲	۰/۲۳۹	مشاهده نشد	مشاهده نشد	مشاهده نشد	۱/۳۰۷	مشاهده نشد	مشاهده نشد	مشاهده نشد
ΣBT EX	۰/۴۸۴	۰/۲۳۹	مشاهده نشد	۲/۱۵۸	۰/۶۰۴	۴/۳۴۶	مشاهده نشد	۲/۱۵۷	۲/۴۹۷

جدول ۳- غلظت ترکیبات BTEX در هوای خروجی اتوکلاو با خردکن بر حسب ppm

هفته ۱	هفته ۲	هفته ۳	هفته ۴	هفته ۵	هفته ۶	هفته ۷	هفته ۸	هفته ۹	هفته ۱۰	
۰/۹۲۲	مشاهده نشد	۰/۶۲۲	مشاهده نشد	مشاهده نشد	مشاهده نشد	۰/۰۸۷	۰/۲۸۳	۰/۲۴۶	۰/۶۷۷	بنزن
۵/۷۲۱	۳/۵۹۲	مشاهده نشد	۶/۹۷	۸/۴۷۷	مشاهده نشد	۱۰/۸۹۲	۶/۵۱۶	۱/۵۸۴	۴/۹۵۵	اتیل بنزن
مشاهده نشد	۰/۸۸	۴/۹۰۲	۷/۰۱۲	۱/۲۷۶	۲/۷۷	۰/۱۹۲	مشاهده نشد	مشاهده نشد	۲/۸۷۷	تولوئن
مشاهده نشد	۶/۰۵۳	۵/۶۷	۰/۸۱۳	مشاهده نشد	مشاهده نشد	۰/۴۱۲	۲/۲۸۵	۰/۱۴۲	۶/۷۱۱	زایلن
۶/۶۴۳	۱۰/۵۲۵	۱۱/۱۹۴	۱۴/۹۹۵	۹/۷۵۳	۲/۷۷	۱۱/۵۸۳	۹/۰۸۴	۱/۹۷۲	۱۵/۲۲	ΣBTEX

جدول ۴- غلظت ترکیبات BTEX در هوای خروجی حرارت خشک بر حسب ppm

هفته ۱	هفته ۲	هفته ۳	هفته ۴	هفته ۵	هفته ۶	هفته ۷	هفته ۸	هفته ۹	هفته ۱۰	
مشاهده نشد	۰/۱۱۸	مشاهده نشد	مشاهده نشد	۰/۲۴۴	۰/۰۶۲	۰/۱۲۲	۰/۲۱۵	مشاهده نشد	۰/۲۳۱	بنزن
۰/۸۳۲	۰/۳۷۸	۰/۳۴۴	مشاهده نشد	۱/۰۲۲	۲/۶۲۶	۰/۵۳	مشاهده نشد	۰/۵۱	۲/۳۳۳	اتیل بنزن
۴/۱۹۳	۲/۹۳۷	۰/۶۱۳	مشاهده نشد	۲/۷۴۳	۴/۴۲۳	۱/۰۸۴	۰/۸۸۸	۵/۲۴	۶/۳۲۸	تولوئن
۰/۴۴۶	۳/۲۷۷	۱/۲۸۶	۰/۲۰۴	۰/۲۰۸	مشاهده نشد	۴/۷۱۶	مشاهده نشد	۱/۴۴۶	۵/۲۶	زایلن
۵/۴۷۱	۶/۶۱	۲/۲۴۶	۰/۲۰۴	۴/۲۱۶	۷/۱۱۱	۶/۴۵۲	۱/۱۰۳	۷/۱۹۶	۱۴/۱۴۲	ΣBTEX

جدول ۵- بالاترین غلظت هر آلاینده بر اساس نوع دستگاه بی خطر ساز

عنوان آلاینده	بالاترین غلظت مشاهده شده بر حسب ppm	دستگاه دارای بالاترین غلظت
بنزن	۰/۹۲۲	اتوکلاو با خردکن
اتیل بنزن	۱۰/۸۹	اتوکلاو با خردکن
تولوئن	۷/۳۳	هیدروکلاو
زایلن	۶/۷۱	اتوکلاو با خردکن
ΣBTEX	۱۵/۲۲	اتوکلاو با خردکن


اندازه گیری شد.

**بررسی آلاینده های استریلایزر حرارت خشک:** تولوئن در ۹۰٪ از نمونه های جمع آوری شده از دستگاه حرارت خشک مشاهده شد و حداکثر غلظت آن ۶/۳۲۸ ppm اندازه گیری شد. اتیل بنزن و زایلن در ۸۰٪ و بنزن در ۶۰٪ نمونه ها حضور داشتند. حداکثر غلظت این ترکیبات به ترتیب ۲/۶۲۶، ۵/۲۶ و ۰/۲۲۴ ppm به دست آمد. BTEX در گستره ی ۱/۹۷۲ تا ۱۱/۵۸۳ ppm مشاهده شد. در جدول شماره ۴ می توان مقادیر عددی آلاینده های دستگاه حرارت خشک را مشاهده نمود.

بالاترین غلظت آلاینده های مشاهده شده برای هر یک از دستگاههای بی خطر ساز مورد مطالعه را می توان در جدول شماره ۵ مشاهده کرد. ملاحظه می شود که بالاترین حد BTEX در اتوکلاو با خردکن به دست آمده است. در نمودار شماره ۱ می توان مقدار میانگین هر

نمونه ها هیچ آلاینده ای را نشان ندادند. بنزن در ۲۰٪ نمونه ها رویت شد و حداکثر غلظت آن ۰/۰۶۳ ppm بود. تولوئن و اتیل بنزن در ۴۰٪ و زایلن در ۳۰٪ نمونه ها مشاهده شدند و حداکثر غلظت این آلاینده ها به ترتیب ۲/۴۹۷، ۲/۹۹۴ و ۱/۳۰۷ ppm به دست آمد. غلظت BTEX در گستره ای بین صفر تا ۴/۳۴۶ ppm قرار داشت. در جدول شماره ۲ می توان نتایج مربوط به دستگاه اتوکلاو بدون خردکن را مشاهده نمود.

**بررسی آلاینده های استریلایزر اتوکلاو با خردکن:** با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره ۳، اتیل بنزن مهم ترین آلاینده ای بود که در ۸۰٪ نمونه های جمع آوری شده از این دستگاه مشاهده شد. حداکثر غلظت اتیل بنزن ۱۰/۸۹۲ ppm به دست آمد. همچنین زایلن و تولوئن در ۷۰٪ نمونه ها و بنزن در ۶۰٪ از نمونه ها مشاهده شدند. حداکثر غلظت زایلن ۶/۷۱۱، تولوئن ۴/۹۰۲ و بنزن ۰/۹۲۲ ppm

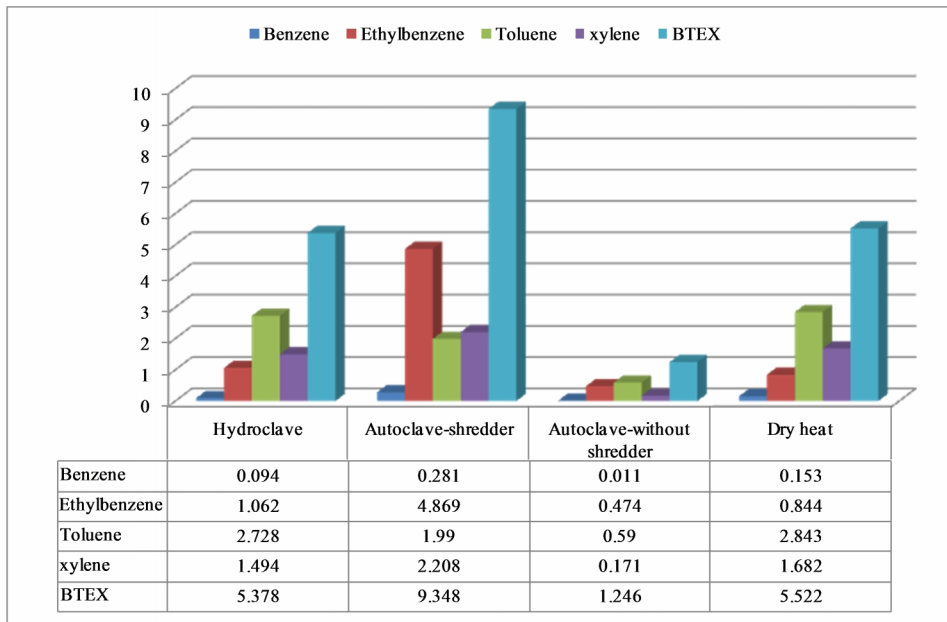

نمودار ۱- مقدار میانگین هر آلاینده به تفکیک نوع دستگاه بی‌خطرساز

جدول ۶- حدود مجاز مواجهه شغلی با ترکیبات BTEX [۲۶]

آلاینده شیمیایی	OEL-TWA (Time Weighted Average)	OEL-STEL (Short Term Exposure Limit)
	حدود مجاز مواجهه شغلی - متوسط وزنی زمانی ppm	حدود مجاز شغلی کوتاه مدت ppm
بنزن	۰/۵	۲/۵
اتیل بنزن	۲۰	---
تولوئن	۲۰	---
زایلین	۱۰۰	۱۵۰

سرطان زای تأیید شده انسانی (A<sub>1</sub>) مطرح بوده و تماس با آن در بیش از حد مقادیر مجاز می‌تواند سبب عوارض انسانی شدید گردد. تماس با بخارات این ترکیب موجب جذب آن از راه‌های جلدی، غشاهای مخاطی و چشم‌ها می‌شود. اتیل بنزن به عنوان سرطان زای تأیید شده برای حیوانات با ارتباط ناشناخته بر انسان (A<sub>3</sub>) می‌باشد که باعث تحریک قسمت فوقانی تنفسی و آسیب‌پذیری کلیوی (نفروپاتی) و اختلال در بخش حلزونی گوش میانی می‌شود. تولوئن و زایلین نیز در گروه A<sub>4</sub> (غیر قابل طبقه بندی به عنوان یک عامل سرطان زای انسانی) طبقه بندی شده‌اند. تحقیقات آزمایشگاهی بر روی حیوانات مختلف اثرات ناگوار این ترکیبات را بر خون،

آلاینده را به برای هر یک از دستگاه‌های بی‌خطرساز مشاهده نمود. همان‌طور که در نمودار شماره ۱ ملاحظه می‌شود، بالاترین غلظت‌های BTEX با میانگین ۹/۳۵ ppm به دستگاه اتوکلاو دارای خردکن و کمترین غلظت BTEX با میانگین ۱/۲۵ ppm به دستگاه اتوکلاو بدون خردکن تعلق دارد. به لحاظ پاکیزگی هوای خروجی، اتوکلاو بدون خردکن، هیدروکلاو، حرارت خشک و اتوکلاو با خردکن به ترتیب رتبه‌های ۱ تا ۴ را به خود اختصاص دادند.

### بحث و نتیجه‌گیری

در بین ترکیبات BTEX، بنزن به عنوان عامل

این آلاینده‌ها از محیط شغلی، سلامت راهبران این دستگاهها را مورد تهدید جدی قرار دهد. از اینرو توصیه می‌شود برای حفظ سلامت این افراد به مجموع غلظت آلاینده‌های دریافتی آنها از طرف محیط آزاد و محیط شغلی توجه گردد.

مقادیر مندرج در جداول ۱ تا ۴ نشان می‌دهد که میزان آلاینده‌های خروجی از یک دستگاه در طی هفته‌های مختلف متفاوت است. این تفاوت‌ها را می‌توان به ترکیب پسماندهای ورودی به دستگاه، نحوه و میزان بارگذاری و اپراتوری این دستگاهها نسبت داد. بالاترین غلظت آلاینده خروجی از این دستگاهها در جدول ۵ بیانگر بدترین شرایط بارگذاری و راهبری این دستگاهها است. متولیان و رهبران می‌توانند با توجه به شرایط موجود در این سیکل‌های کاری نسبت به اصلاح آنها اقدام نمایند.

نتایج عددی نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد که نوع و میزان آلاینده‌های تولیدی از دستگاهی به دستگاه دیگر متفاوت است. با توجه به عمر کوتاه بهره‌برداری از این تاسیسات در بیمارستانهای مورد مطالعه (۳ تا ۹ ماه)، این تفاوت‌ها را می‌توان عمدتاً به نوع دستگاه، دما و فشار کاری آن و وجود و یا عدم وجود تاسیسات خردسازی پسماند در این دستگاهها نسبت داد [۳۵].

بالاترین میانگین غلظت آلاینده‌ها در این تحقیق مربوط به دستگاه اتوکلاو با خردکن می‌باشد. خردسازی در این دستگاه پیش از عملیات بی‌خطر سازی صورت می‌گیرد و این حالت می‌تواند عاملی برای تولید بیشتر ترکیبات آلی فرار در هوای خروجی باشد. در این شرایط ترکیبات سمی ناشی از مواد پلاستیکی با سرعت بیشتری تبخیر شده و وارد هوای محیط می‌گردند [۳۶]. در نقطه‌ی مقابل، اتوکلاو بدون خردکن پایین‌ترین غلظت آلاینده‌ها را نشان داده است. این مساله بیانگر این است که حذف خردسازی می‌تواند باعث کاهش ترکیبات آلی فرار در هوای خروجی سیستم‌های بی‌خطر ساز حرارتی با دمای پایین شود.

با توجه به عمر کوتاه دستگاههای بی‌خطر ساز

کبد، کلیه و ریه را تأیید نموده است. علاوه بر این، تأثیرات حاد و مزمن ترکیبات BTEX بر روی سیستم عصبی به اثبات رسیده است به طوری که علائمی نظیر کاهش هوشیاری، دو بینی، سردرد و حتی بیهوشی و اغما در تماس‌های کوتاه با غلظت‌های بالای این ترکیبات گزارش شده است [۲۶، ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱]. از این رو اداره بهداشت و ایمنی شغلی (OSHA)، انستیتو ملی ایمنی و بهداشت شغلی (NIOSH) و مجمع دولتی متخصصان بهداشت صنعتی آمریکا (ACGIH) برای این ترکیبات حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL) تعیین کرده‌اند [۲۴ و ۲۵]. در این تحقیق نتایج نهایی بدست آمده از نمونه‌ها با حدود مجاز مواجهه شغلی کوتاه مدت (OEL- STEL) ارائه شده توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت مندرج در جدولی شماره‌ی ۶ مورد مقایسه قرار گرفت [۲۶].

غلظت گازهای بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در تمام نمونه‌ها از حدود مجاز مواجهه شغلی کوتاه مدت (OEL- STEL) ارائه شده توسط مرکز سلامت محیط و کار، کمتر بود ( $p < 0.05$ ). اما با لحاظ کردن تماس‌های جانبی افراد با ترکیبات BTEX در هوای آزاد خصوصاً در هوای آلوده شهرهای بزرگ همواره مقادیر بیشتری از این ترکیبات توسط پرسنل مرتبط دریافت می‌شود [۳۲ و ۳۳].

طبق تحقیقات صورت گرفته همواره غلظت زمینه‌ای از ترکیبات آروماتیک به خصوص بنزن و تولوئن در هوای آزاد شهرها وجود دارد. به عنوان مثال در تحقیقی که توسط بهرامی در هوای شهر تهران صورت گرفت، غلظت بنزن، تولوئن و زایلن به ترتیب  $127/7$ ،  $201/2$  و  $110/7$  میکروگرم بر متر مکعب به دست آمد [۳۴]. این مقادیر از استانداردهای زیست محیطی بنزن در هوای آزاد بسیاری از کشورها (استاندارد اروپا  $1/57$  ppb و استاندارد ایران  $1/5$  ppb) به مراتب بیشتر است [۳۳ و ۳۴]. دریافت غلظت بیش از حد استاندارد این ترکیبات آلاینده از طریق هوای آزاد موضوعی است که می‌تواند با توجه به دریافت

عنوان عامل اصلی این اختلاف محسوب گردد. تحقیق کاراگیانیدیس و همکاران در مقدونیه، همانند تحقیق حاضر، هوای خروجی از دستگاه‌های هیدروکلاو و اتوکلاو را در حد مجاز گزارش کرده است [۴۱]. با این وجود در این تحقیق و بسیاری از مطالعات مشابه با توجه به شرایط خاص این دستگاه‌ها، توصیه شده است که برنامه‌های پایش و کنترل هوای خروجی از این دستگاه‌ها بطور مستمر مورد توجه مسئولین قرار داشته باشد.

- به لحاظ پاکیزگی هوای خروجی، اتوکلاو بدون خرد کن، هیدرو کلاو، حرارت خشک و اتوکلاو با خرد کن به ترتیب رتبه‌های ۱ تا ۴ را به خود اختصاص دادند.

- حضور ترکیبات آلی فرار نظیر بنزن در هوای خروجی این دستگاه‌ها، نشانگر لزوم توجه بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست در تصویب مقررات مربوط به هوای خروجی از این تاسیسات می‌باشد.

- تدوین دستورالعمل‌های راهبری متناسب با فرآیند کاری این دستگاه‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد این تاسیسات در کشور کمک کند.

- انتظار می‌رود که با افزایش عمر این دستگاه‌ها میزان انتشار گازهای سمی در آنها افزایش یابد از اینرو پایش و کنترل مداوم کیفیت هوای خروجی این تاسیسات بایستی اکیدا مورد توجه قرار گیرد.

### تقدیر و تشکر

این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی ترکیبات آلی فرار و PET و پرفتالات در پساب و هوای خروجی دستگاه‌های بی‌خطرساززباله بیمارستانی با حرارت پایین در چهار بیمارستان شهر تهران ۹۰-۱۳۸۹" به شماره ۱۲۶۰۷-۱۳۲-۰۴-۸۹ می‌باشد که با حمایت مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اجرا شده است.

زباله‌های بیمارستانی با حرارت پایین در ایران می‌تواند پیش بینی نمود که با گذشت زمان و استهلاک بیشتر این دستگاه‌ها به مرور زمان میزان انتشار آلاینده‌های خروجی آنها در هوا افزایش یابد. تحقیقی که در سال ۲۰۰۶ بر روی هیدروکلاو زباله بیمارستانی در باترورث انجام شد، نشان داد که وسایل پلاستیکی در اثر حرارت در این دستگاه‌ها ذوب شده و موجب انتشار مواد سمی به هوای اطراف می‌گردد. این تحقیق همچنین نشان داد که میزان انتشار مواد آلی و بخارات سمی منتشره از این دستگاه‌ها با افزایش عمر آنها افزایش یافته است [۳۷]. حضور ترکیبات BTEX در هوای خروجی در تحقیق حاضر مشابه تحقیقی است که ویلاورت و همکاران در سال ۲۰۰۹ با عنوان "بررسی میزان آئروسول‌های بیولوژیکی و ترکیبات آلی فرار در یک واحد اتوکلاو زباله‌ی بیمارستانی" انجام دادند. در این مطالعه میانگین غلظت بنزن ۲/۵ ppm به دست آمد که البته در مقایسه با پژوهش حاضر مقدار بسیار بیشتری را نشان می‌دهد [۳۸].

میزان تولید ترکیبات BTEX در تحقیق حاضر با نتایج مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۰ با عنوان "ارزیابی ترکیبات آلی فرار در هیدروکلاو مستقر در بیمارستان کینگستون" ببردال انجام شد همخوانی دارد. در این مطالعه میانگین غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن‌ها به ترتیب ppm ۰/۰۰۶، ۰/۱۱، ۰/۵۶ و ۰/۰۰۹ گزارش شده بود [۳۹]. تحقیق دیگری که توسط موسسه‌ی OSHA در سال ۲۰۰۷ انجام شد نشانگر حضور ترکیبات آلی فرار بیش از استانداردهای EPA در خروجی‌های دستگاه‌های بی‌خطرساز زباله‌ی بیمارستانی در ۲۰ بیمارستان مورد مطالعه بود. در تحقیق OSHA بیشترین غلظت ترکیبات آلی فرار مربوط به ۲-پروپانول با غلظت میانگین ۴/۳ میلی‌گرم در مترمکعب و وینیل کلراید با غلظت میانگین ۲/۶ میلی‌گرم در متر مکعب بود. در مقایسه با تحقیق حاضر، در تحقیق OSHA ترکیباتی مشاهده شده است که در آزمایشات ما دیده نشده‌اند [۴۰]. تفاوت در نوع دستگاه و نوع پسماند بیمارستانی می‌تواند به



## منابع

14. Ezechiel O L. Healthcare waste management status in Lagos State, Nigeria: a case study from selected healthcare facilities in Ikorodu and Lagos metropolis. *Waste Management & Research*. 2012; 30(6): 562-571.
15. Armstrong B. A, Reinhardt P. A. Managing laboratory biomedical waste using a large on-site autoclave–shredder, *Journal of Chemical Health and Safety*. 2010;17(6):33–39.
16. Moussavi G, Bahadori M.B, Farzadkia M, Yazdanbakhsh A, Mohseni M. Performance evaluation of a thermophilic biofilter for the removal of MTBE from waste air stream: Effects of inlet concentration and EBRT. *Biochemical Engineering Journal*. 2009; 45 (2)152-156.
17. Byung-Hwan K, Jeong-Hyeon K, Jong-In D, Sung-Taek I, Kyung-Hee K, Seong-Suk S, Jin-Won P. Control of dioxins for ISW incinerator emissions by a dual bag filter system with enhanced AC utilization. IT3'05 Conference, May 9-13, 2005, Galveston, Texas
18. Environment Australia. Incineration and Dioxins: Review of Formation Processes, consultancy report prepared by Environmental and Safety Services for Environment Australia, Commonwealth Department of the Environment and Heritage, Canberra, 1999.
19. Mahoney P F, Pierce G G, Sutin G L. Minimum dioxin with maximum resource recovery. Dioxin '97 Indiana University Conferences. 1997. Bloomington, IN 47404(812) 855-6449.
20. Tiller T, Linscott A. Evaluation of a Steam Autoclave for Sterilizing Medical Waste at a University Health Center. *American Journal of Infection Control*. 2004; 32(3) E9.
21. Levendis Y A, Atal A, Carlson J B, Mar Esperanza Quintana M. PAH and soot emissions from burning components of medical waste: examination/surgical gloves and cotton pads. *Chemosphere*. 2001; 42 (5-7):775-783.
2. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition, 5/15/96. Available from: <http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/2549.pdf>
23. Center for Environmental Research Information Office of Research and Development, USEP. Determination Of Volatile Organic Compounds (VOCs) In Ambient Air Using Specially Prepared Canisters With Subsequent Analysis By Gas Chromatography. 1999; EPA/625/R-96/010b, Cincinnati, OH 45268
24. American Conference of Governmental Industrial (ACGIH). Threshold Limit Values for
1. Farzadkia M, Jorfi S, Akbari H, Ghasemi M. Evaluation of dry solid waste recycling from municipal solid waste: Case of Mashhad city, Iran. *Waste Management & Research*, 2012; 30(1): 106-112.
2. Farzadkia M, Moradi A, Shahmohammadi M. Hospital waste management status in Iran: a case study in the teaching hospitals of Iran University of Medical Sciences. *Waste Management & Research*, 2009; 27(4): 384–389.
3. Halbowachs H. Solid waste disposal in district Health Facilities Agency for Technical cooperation, Germany, World Health Forum Switzerland. 1994; 15(4):363-7.
4. World Health Organization Policy Paper. Safe health-care waste management, 2004
5. Akter N. Medical Waste Management: A Review. Asian institute of Technology. Thailand. 2000.
6. Bazrafshan E, Kord Mostafapoor F. Survey of medical waste characterization and management in Iran: a case study of Sistan and Baluchestan Province. *Waste Management & Research*, 2010; 29(4): 442–450.
7. Modabery S. Hospital waste in Tehran city: Incineration or sterilizing. *Solid waste management*, 2007; 8: 286-291. (In Persian)
8. Environmental and occupational health center, Iranian ministry of health and medical education. A guide to training materials for health care waste management. 2012. (In Persian)
9. Lee B K, Ellenbecker M J, Moure-Ersaso R. Alternatives for treatment and disposal cost reduction of regulated medical wastes. *Waste Management*, 2004; 24;143-151.
10. Miyazaki M, Une H. Infectious waste management in Japan: A revised regulated and a management process in medical institutions. *Waste management*, 2005;25(6):616-21.
11. Birpınar ME, Bilgili MS, Erdoğan T. Medical waste management in Turkey: A case study of Istanbul. *Waste Management*, 2009; 29(1):445-8.
12. Mohammadi Baghei D. Principles of management of solid waste in clinical and laboratorial centers. Tehran: shahrab; 2001. (in Persian)
13. Ferdowsi A, Ferdosi M, Mehrani M J. Incineration or Autoclave? A Comparative Study in Isfahan Hospitals Waste Management System (2010). *Mat Soc Med*. 2013; 25:48-51.

- 401242, Aesthetic Waste Services, 2006.
38. Vilavert L, Nadal M, Inza I, Figueras J M, Domingo J L. Baseline levels of bioaerosols and volatile organic compounds around a municipal waste incinerator prior to the construction of a mechanical-biological treatment plant. *waste management*. 2009; 29:2454-2461.
39. UNEP. Preliminary evaluation of volatile organic compounds associated with a hydroclave cycle at Kingston general hospital. *Compendium of Technologies for Treatment/Destruction of Healthcare Waste*. 2012
40. Cole E. C, Owen K, Leese K. E, Hodson L, Uhorchak R, Greenwood D, and VanOsdell D. Control of Aerosol (Biological and Nonbiological) and Chemical Exposures and Safety Hazards in Medical Waste Treatment Facilities. Final Report for the National Institute of Occupational Safety and Health, Division of Physical Sciences and Health Engineering Control Technology Branch. RTI project No. 93U-6449. Contract No. 200-95-2960, 1997.
41. Karagiannidis A, Papageorgiou A, Perkoulidis G, Sanida G, Samaras P. A multi-criteria assessment of scenarios on thermal processing of infectious hospital wastes: A case study for Central Macedonia. *Journal of waste management*. 2010; 30(2): 251-62.
- chemical substance and agents and biological exposure indices. 2011, ACGIH Signature Publication, Cincinnati, Ohio.
25. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Occupational safety and health standards: Toxic and hazardous substances, Limit for air contaminants. 29 CFR 1910, subpart Z, Last adopted: 2006, Washington DC, USA.
26. Ministry of Health and Medical Education, Center for Environmental and Occupational health. Occupational Exposure Limits (OEL), Third Edition, Institute for Environmental Research (IER) Publication, 2012.
27. Bahrami A. Sampling methods and air pollutants analyses. Tehran: Fanavaran, 2008. (In Persian)
28. ATSDR. Toxicological profile for benzene. US Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA. 2007a.
29. ATSDR. Draft toxicological profile for ethylbenzene. US Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA. 2007b.
30. ATSDR. Toxicological profile for xylene. US Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA. 2007c.
31. ATSDR. Toxicological profile for toluene. US Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA. 2007c.
32. TOSC. Environmental briefs for citizen. BTEX Contamination. Available from: [http://www.egr.msu.edu/tosc/akron/factsheets/fs\\_btexpdf.pdf](http://www.egr.msu.edu/tosc/akron/factsheets/fs_btexpdf.pdf)
33. ACGIH. Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 7th Ed. 2001.
34. Bahrami AR. Distribution of volatile organic compounds in ambient air of Tehran. *Arch Environ Health* 2001; 56(4):380-383.
35. Allen M R. Effective pollution prevention in healthcare environments. *Journal of cleaner production*. 2006; 14: 610-615.
36. Abu Samah M.A, Abd Manaf L, Zaharin Aris A, Wan Nor Az.Sn. Solid Waste Management: Analytical Hierarchy Process (AHP) Ppplcation of Selecting Treatment Technology in Sepang Municipal Council, Malaysia. *Current World Environment*. 2011; 6 (1): 1-16.
37. Ninham Sh. Consulting Services. Final scoping report for Hydroclave medical waste treatment plant in Butterworth, Eastern Cape, Report No: 405/

## Study of the volatile organic compounds (VOCs) in the exhaust air from low heat sterilizer devices of four hospitals in Tehran

M. Farzadkia<sup>1</sup>, H. Gholami<sup>2</sup>, A. Esrafil<sup>3</sup>, A.A. Farshad<sup>4</sup>, M. Kermani<sup>5</sup>

Received: 2013/05/13

Revised: 2013/08/22

Accepted: 2013/10/26

### Abstract

**Background and aims:** Application of low heat devices was increased for infectious waste sterilizing in many hospitals in Iran. Studies have shown that the generation of volatile organic compounds (VOCs) and hazardous materials is most probable in the exhaust air of these devices. The main objective of this research is study of VOCs (in the exhaust air from low heat sterilizer devices of four hospitals in Tehran city.

**Methods:** This research was accomplished in some hospitals using sterilizer devices such as: Hydroclave, Autoclave-shredder, and Autoclave without shredder and Heat dryer. Ten samples were taken from each device every week from April to July 2011. Sampling was done by NIOSH 1501 method. Samples were analyzed in two qualitative and quantitative phases by GC-MASS and the obtained results were compared with occupational exposure short term limits (OEL- STEL) recommended by Center for Environmental and Occupational Health, Iranian Ministry of Health.

**Results:** In the first phase of research (qualitative analysis), in 90% of samples only BTEX compounds (Benzene, Toluene, Ethyl Benzene and Xylene) were observed. Based on the results of the second phase, the highest and the lowest concentration of BTEX with 9.35 ppm and 1.25 ppm were determined to be related to Autoclave-shredder and Autoclave without shredder, respectively. According to exhaust air clarity, Autoclave without shredder, Hydroclave, Heat dryer and Autoclave-shredder were scored from 1 to 4, respectively.

**Conclusion:** The concentrations of Benzene, Toluene, Ethyl Benzene and Xylene in all samples were lower than the occupational exposure short term limits. The presence of VOCs in the majority of collected samples, considering the short lifetime of these devices (between 3 to 9 months), confirmed that there is a high potential risk of exposure resulted by these devices. Therefore, monitoring of exhaust air quality of such devices is required.

**Keywords:** Low heat waste sterilizers, Hospital wastes, Volatile organic compounds, BTEX, Air.

1. (**Corresponding author**) Department of Environmental Health Engineering, Occupational Health Research Center, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. mahdifarzadkia@gmail.com

2. Department of Environmental Health Engineering, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3. Department of Environmental Health Engineering, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4. Occupational Health Research Center, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

5. Department of Environmental Health Engineering, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.